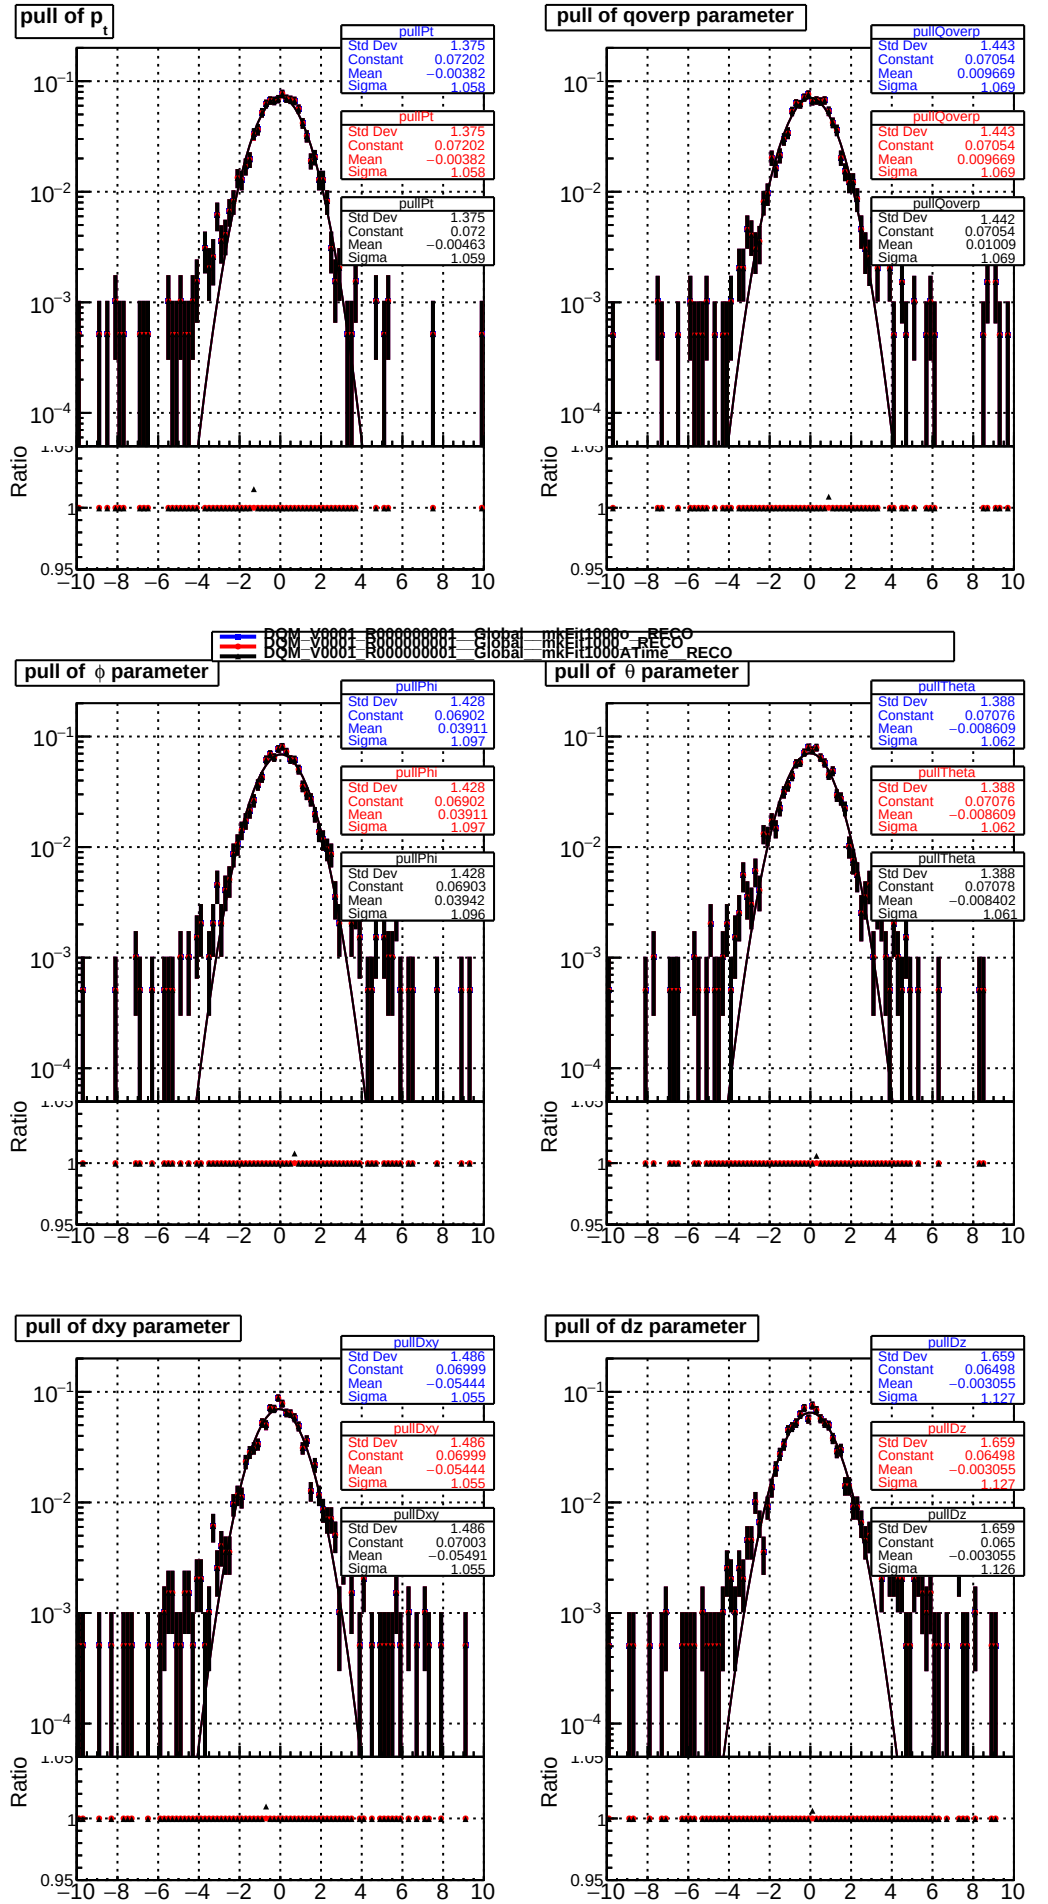
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.375
Constant 0.07202
Mean −0.00382
Sigma 1.058
pullPt
Std Dev 1.375
Constant 0.07202
Mean −0.00382
Sigma 1.058
pullPt
Std Dev 1.375
Constant 0.072
Mean −0.00463
Sigma 1.059
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.07054
Mean 0.009669
Sigma 1.069
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.07054
Mean 0.009669
Sigma 1.069
pullQoverp
Std Dev 1.442
Constant 0.07054
Mean 0.01009
Sigma 1.069
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000ATime__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.428
Constant 0.06902
Mean 0.03911
Sigma 1.097
pullPhi
Std Dev 1.428
Constant 0.06902
Mean 0.03911
Sigma 1.097
pullPhi
Std Dev 1.428
Constant 0.06903
Mean 0.03942
Sigma 1.096
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.388
Constant 0.07076
Mean −0.008609
Sigma 1.062
pullTheta
Std Dev 1.388
Constant 0.07076
Mean −0.008609
Sigma 1.062
pullTheta
Std Dev 1.388
Constant 0.07078
Mean −0.008402
Sigma 1.061
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.486
Constant 0.06999
Mean −0.05444
Sigma 1.055
pullDxy
Std Dev 1.486
Constant 0.06999
Mean −0.05444
Sigma 1.055
pullDxy
Std Dev 1.486
Constant 0.07003
Mean −0.05491
Sigma 1.055
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.659
Constant 0.06498
Mean −0.003055
Sigma 1.127
pullDz
Std Dev 1.659
Constant 0.06498
Mean −0.003055
Sigma 1.127
pullDz
Std Dev 1.659
Constant 0.065
Mean −0.003055
Sigma 1.126
Ratio